




INTUBATION OROTRACHEALE

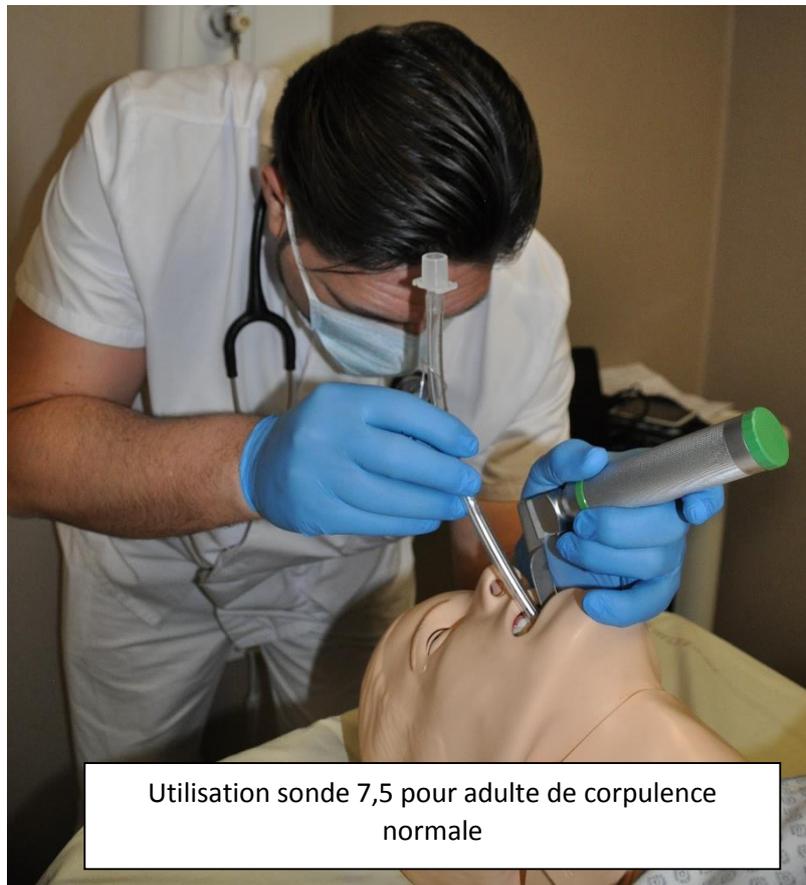


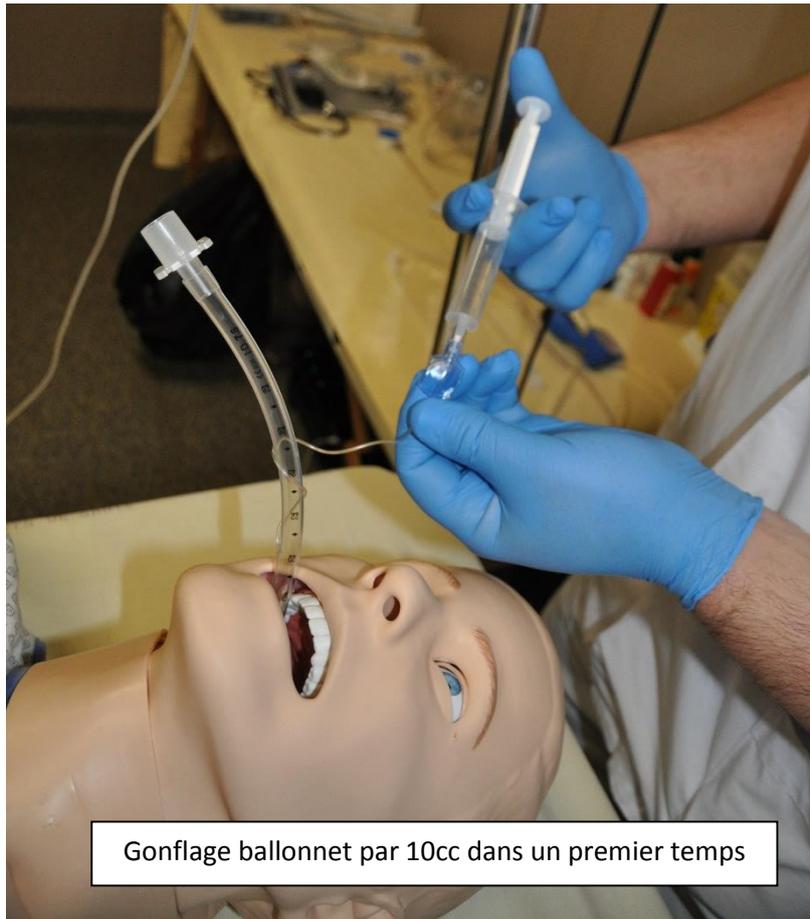

Gonflage ballonnet par 10cc dans un premier temps

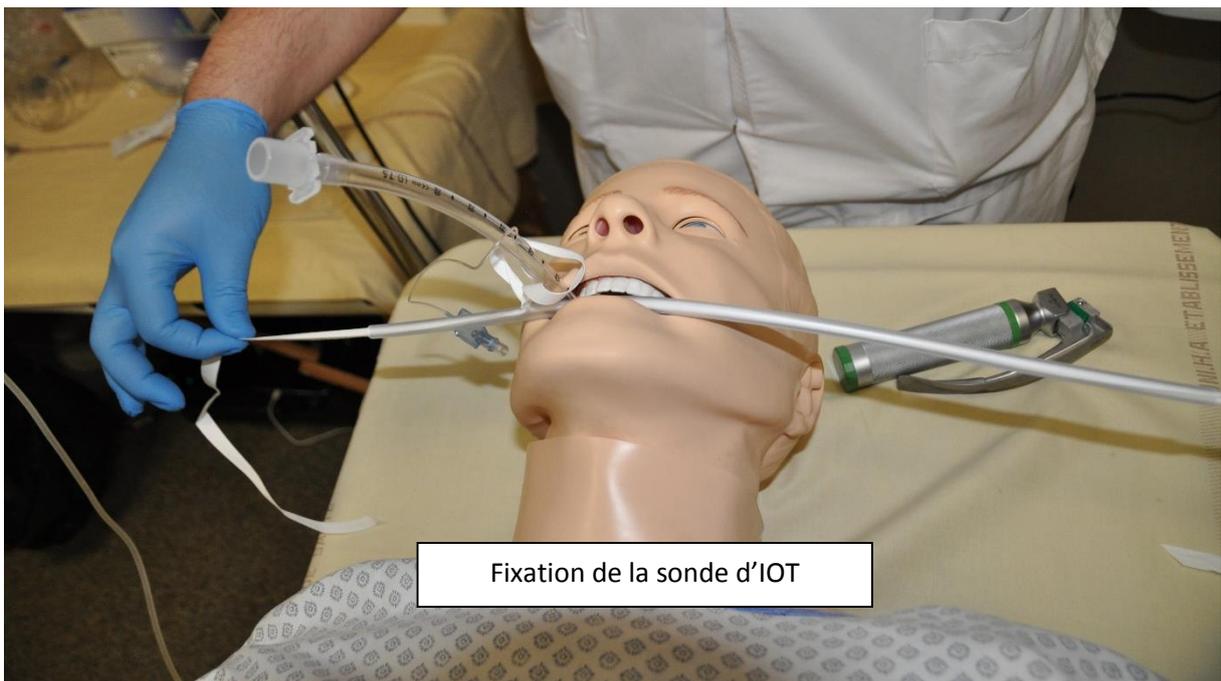

Fixation de la sonde d'IOT

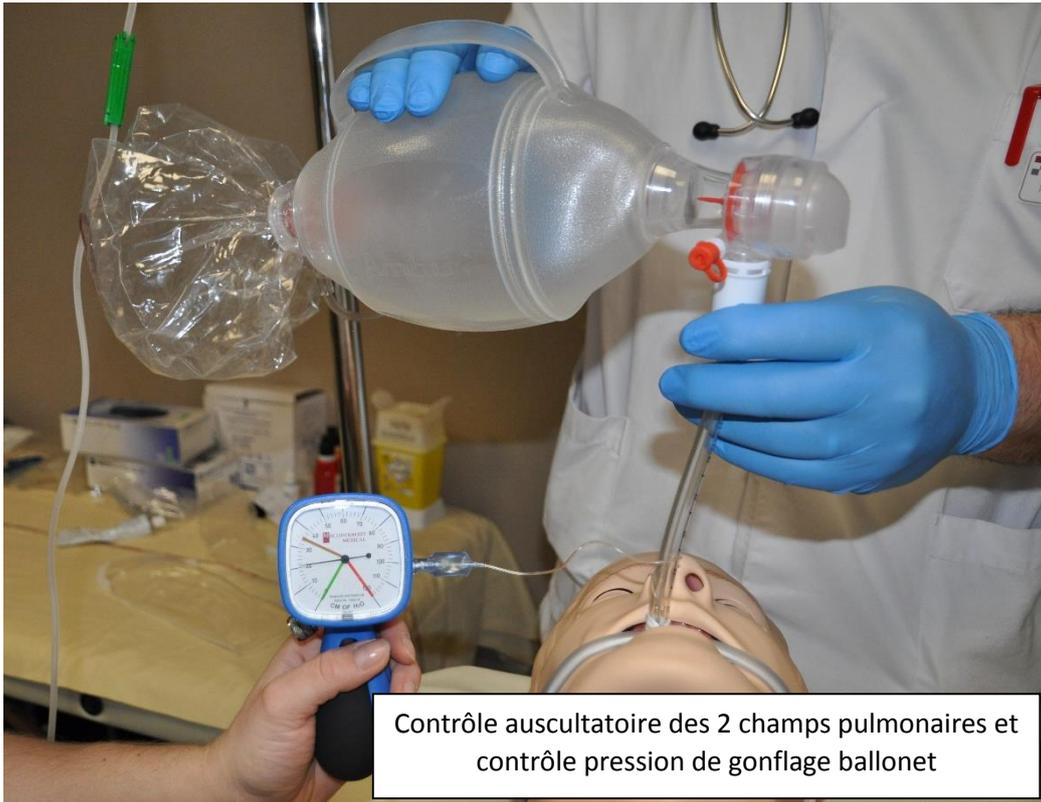

Contrôle auscultatoire des 2 champs pulmonaires et
contrôle pression de gonflage ballonnet